


## 5.2 仪器机时预约使用

用户审核通过后可以登入系统进行相关仪器的预约操作，具体仪器预约步骤如下图所示：

### ◇ 机时预约使用流程

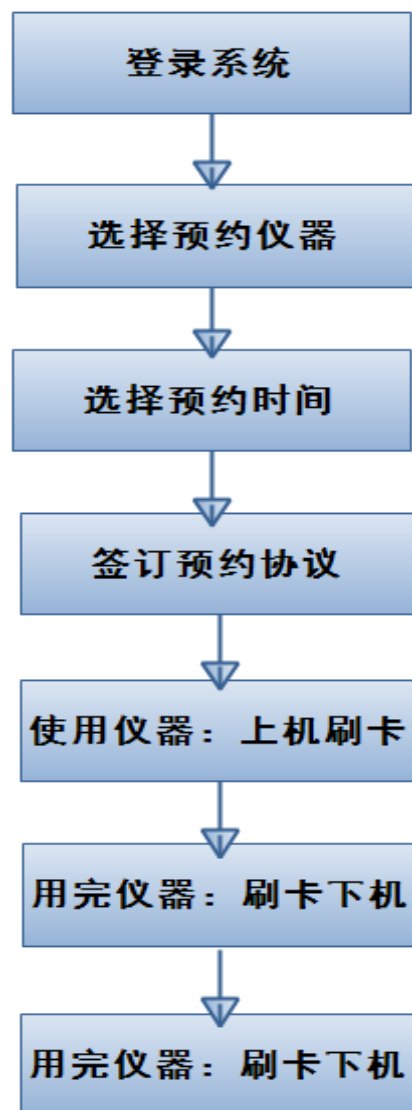

### 5.2.1 登录系统

用户在 IE 浏览器输入大型仪器共享平台的网址，点击网站的右上方的“登录”按钮，输入用户名及密码，点击“登入”，如下图：




### 5.2.2 选择预约仪器

用户登录系统后，通过点击“设备预约”或者“个人中心”里的“仪器设备”搜索查找相关仪器，如下图：



➤ 点击“设备预约”查找仪器，如下图。

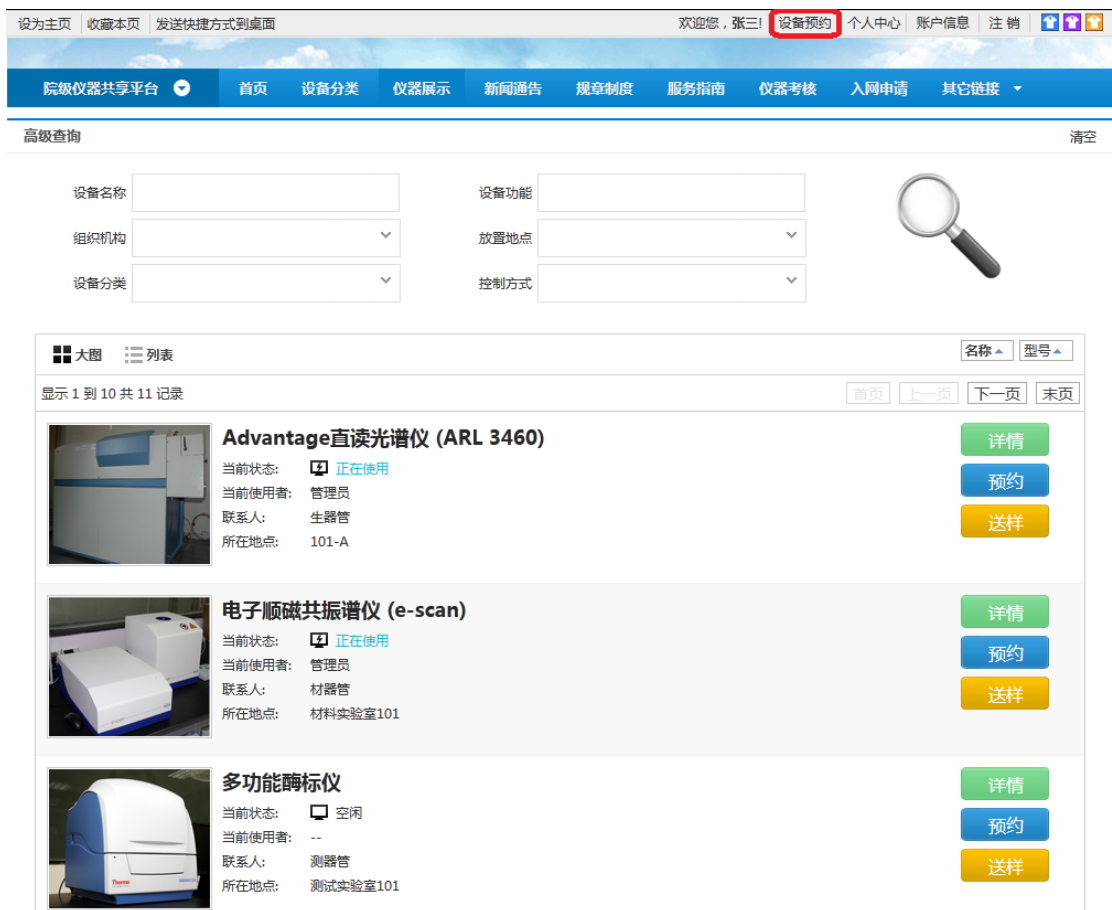

➤ 点击“个人中心”中的“仪器设备”查找仪器，如下图。



### 5.2.3 选择预约时间

查找到仪器后，可以通过“详情”按钮查看仪器相关的详细信息，点击“预约”

按钮便可进行仪器预约操作。

➤ 点击“详情”（下图）

高级查询 清

设备名称  设备功能   
组织机构  放置地点   
设备分类  控制方式

已选条件: 组织机构: 清华大学环境学院 名称 ▲ 型号 ▲

显示 1 到 10 共 11 记录 首页 上一页 下一页 末页

 **Advantage直读光谱仪 (ARL 3460)** 详情  
当前状态: 正在使用  
当前使用者: 管理员  
联系人:   
所在地: 101-A  
预约  
送样

 **电子顺磁共振谱仪 (e-scan)** 详情  
当前状态: 正在使用  
当前使用者: 管理员  
联系人:   
所在地: 材料实验室101  
预约  
送样

➤ 查看仪器相关信息（下图）

Advantage直读光谱仪 (ARL 3460)



**13** 收藏者 | **8** 使用者 | **8** 总次数 | **373** 总时长

设备型号: ARL 3460  
当前状态: 空闲  
当前使用者: 管理员  
联系人: 生露管  
联系电话: 13800138201  
所在地: 101-A

100元 / 小时

信息 预约资源 评论 附件下载 (1) 公告 (1) 同属设备

名称	Advantage直读光谱仪	厂商编号	00100092	型号	ARL 3460P
规格		产地	美国	厂家	美国热电
所属品牌		生产周期		购买周期	
所属单位	清华大学环境学院	使用性质	科研	所属分类	
联系人	生露管	联系电话	13800138201	联系邮箱	hsaodwin@qq.com
放置地点	101-A				

**主要功能及特点**

性能指标:

最多测通数 60条

分析时间 按样品类型而定, 一般不到一分钟。

光源 三种光源: 1080qr/mm : 1667 qr/mm : 2160 qr/mm

应用范围:

ARL 3460多通道直读光谱仪主要用于金属材料的质量、重量分析。


➤ 点击“预约”（如下图）

设备名称  设备功能   
组织机构  放置地点   
设备分类  控制方式

已选条件: 组织机构: 清华大学环境学院


大图 列表 名称 型号

显示 1 到 10 共 11 记录 首页 上一页 下一页 末页



**Advantage直读光谱仪 (ARL 3460)**  
当前状态:  正在使用  
当前使用者: 管理员  
联系人:  
所在地点: 101-A

[详情](#)  
[预约](#)  
[送样](#)



**电子顺磁共振谱仪 (e-scan)**  
当前状态:  正在使用  
当前使用者: 管理员  
联系人:  
所在地点: 材料实验室101

[详情](#)  
[预约](#)  
[送样](#)

➤ 选择预约时间（下图）

设备预约

Advantage直读光谱仪(ARL 3460)的汇总信息(点击展开)

Advantage直读光谱仪(ARL 3460)的概要信息(点击展开)

Advantage直读光谱仪(ARL 3460)的资源信息

2013-08-11 ~ 2013-08-17 << 上周 本周 下周 >>

预约时间段	08.11 星期天	08.12 星期一	08.13 星期二	08.14 星期三	08.15 星期四	08.16 星期五	08.17 星期六
00:00-00:30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
00:30-01:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01:00-01:30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
01:30-02:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02:00-02:30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02:30-03:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03:00-03:30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03:30-04:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04:00-04:30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

可预约  不可预约  已选择  自己预约  他人预约

开放时间: 0.00-24.00 工作日: 日 一 二 三 四 五 六  
收费标准: 100元 / 小时 最多提前预约 1 天, 最少提前 30 分钟预约

上一步 下一步

➤ 预约用户信息填写（可不填，直接下一步，如下图）

设备预约

### 用户预约基本信息

预约人 \* 张三

课题组 \* 张三的课题组

使用性质 \* 科研

实验内容

备注选项 \*

上一步 下一步

## 5.2.4 阅读预约相关规定并提交预约

设备预约

### 1. 设备概要

设备名称	Advantage直读光谱仪	型号	ARL 3460
放置地点	101-A		

### 2. 预约信息

预约人	张三	课题组	张三的课题组
导师姓名	张三	使用性质	科研

### 3. 预约时间

开始时间	结束时间	时长
2013年08月13日 00时00分	2013年08月13日 01时00分	1
		共:1

### 4. 设备使用说明注意事项

### 5. 不良行为处罚规定

不良行为为严重程度规定

不良行为	严重程度
没清洁	1
爽约	2
损坏设备	10

当用户不良行为累计到一定程度,将对他作出如下处罚

处罚类型	严重程度累计	处罚持续天数
发警告给个人	10	
发警告给导师	20	
不允许预约	30	5
不允许使用	40	

我已仔细阅读并同意以上条款

上一步 完成

### 5.2.5 预约成功提示



您的预约已提交,请在预约时间前24小时登录确认!您当前的预约时间如下:

开始时间	结束时间	时长
2013年08月13 00时00分	2013年08月13 01时00分	1
		共1

[← 返回](#)

### 5.2.6 仪器使用（刷卡上机，下机刷卡）

用户在预约的时间范围内，携带注册登记时的校园卡，刷卡（打开相应的门禁、或电脑、或电源）开机使用仪器，用完仪器后，刷卡下机。